


Conseils pour le prélèvement de sang total au bout du doigt

Bras tendu le long du corps (position décline), main au niveau de la taille


Prélèvement facilité par le lavage préalable des mains à l'eau chaude

1 PRÉLÈVEMENT

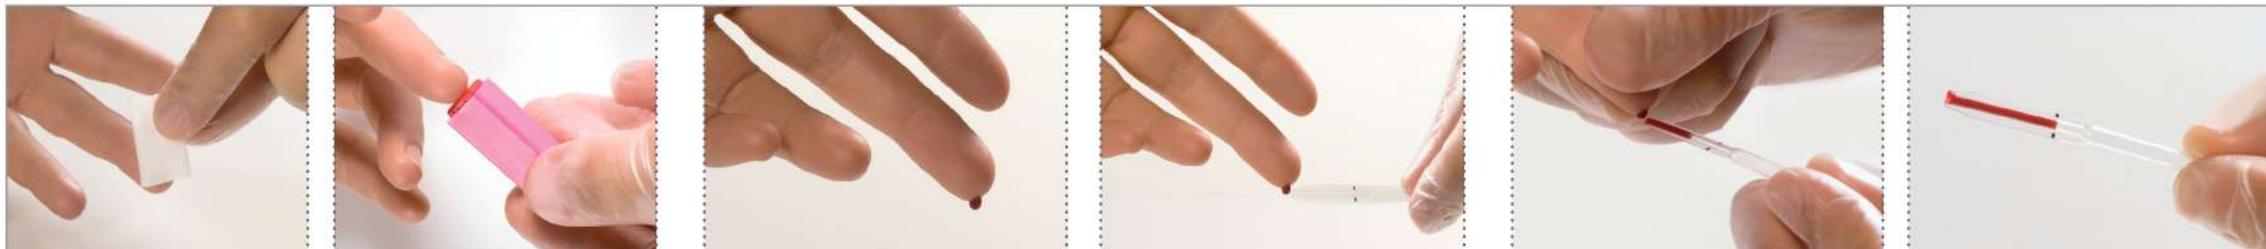

- Identifier le test INSTI™ Multiplex
Désinfecter le doigt (en évitant la pince)
- Piquer le **doigt propre** du patient
- Former **une grosse goutte** de sang suspendue
- Recueillir la **goutte de sang** suspendue en approchant la pipette **horizontalement** de la goutte
- Former une **nouvelle goutte de sang** suspendue et la recueillir de la même façon en gardant la **pipette à l'horizontale**
- Répéter l'opération jusqu'à ce que le sang ait atteint le **trait noir** de la pipette

2 RÉALISATION DU TEST


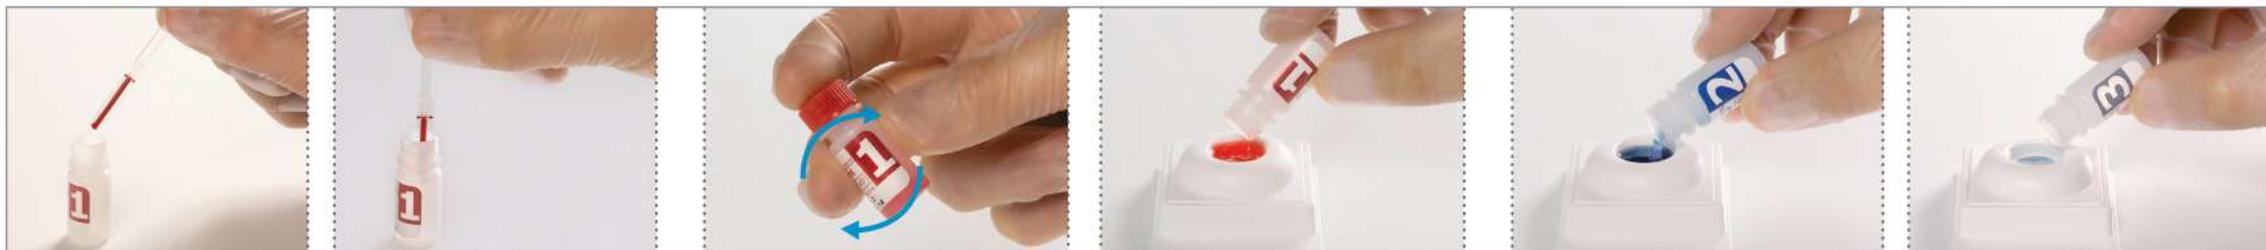


- Introduire la pipette **au fond du flacon 1**
- Presser la poire de la pipette pour vider le sang dans le **flacon 1**
- Refermer le flacon et l'homogénéiser par 2 inversions
- **Vider le contenu du flacon 1** dans la cupule et attendre que le liquide ait traversé la membrane
- **Vider le contenu du flacon 2**
- **Vider le contenu du flacon 3** et lire le résultat du test **immédiatement**

Lecture / Interprétation des résultats

4 possibilités


Un point		Deux points		Deux points		Trois points	
VIH	Syphilis	VIH	Syphilis	VIH	Syphilis	VIH	Syphilis
-	-	+	-	-	+	+	+

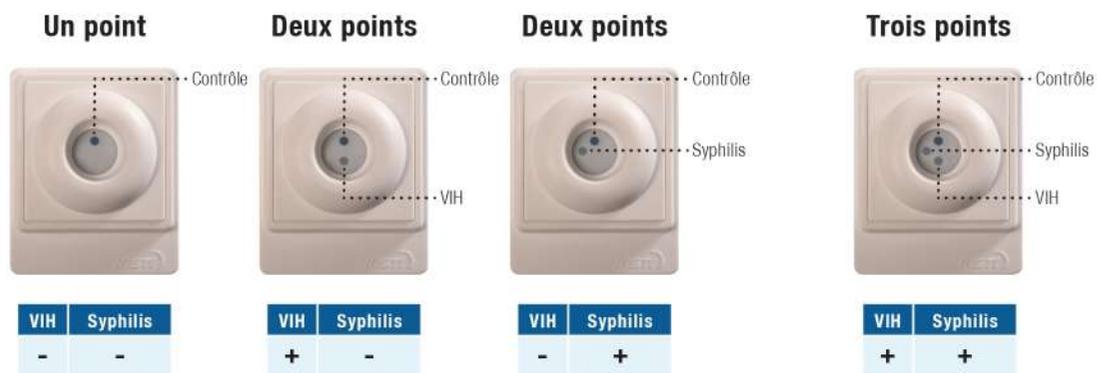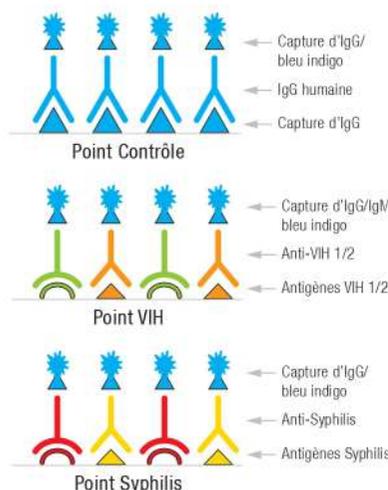Résultats ininterprétables

INVALIDE
Pas de point Contrôle ni de points Test

INDÉTERMINÉS
Point Contrôle avec faibles anneaux dans les zones Test

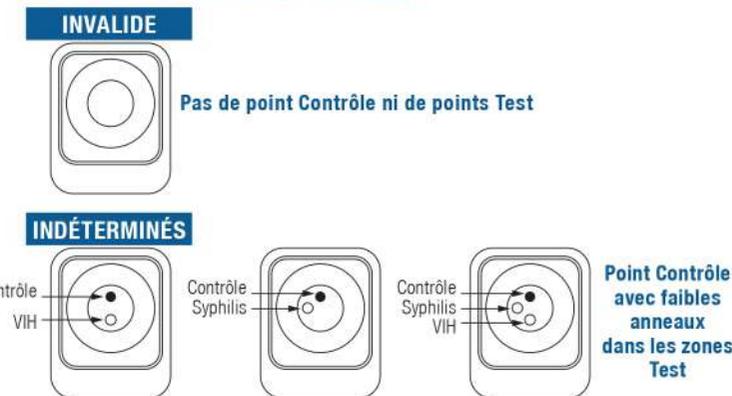

Recommandation : tout test ininterprétable doit être répété avec un **nouvel échantillon sanguin** en utilisant un **nouveau test INSTI™ / INSTI™ Multiplex** et de **nouveaux accessoires**